



**ZytoLight**

## **SPEC IGK Dual Color Break Apart Probe**

**REF** Z-2288-50

5 (0,05 ml)

Para la detección cualitativa de translocaciones que afectan al gen IGK humano en 2p11.2 mediante hibridación *in situ* con fluorescencia (FISH)



Producto sanitario para diagnóstico *in vitro*  
conforme a la Directiva europea 98/79/CE

### 1. Uso previsto

La sonda ZytoLight SPEC IGK Dual Color Break Apart Probe (PL243) está diseñada para la detección cualitativa de translocaciones que afectan al locus IGK (locus kappa de inmunoglobulina, también conocido como IGK@, IGK) en 2p11.2 en muestras citológicas o muestras fijadas en formol e incluidas en parafina como tejido de linfoma mediante hibridación *in situ* con fluorescencia (FISH). La sonda está prevista para su uso en combinación con ZytoLight FISH Implementation Kits (Ref. Z-2028-5/-20 o Z-2099-20).

Los resultados deben ser interpretados por un anatomopatólogo cualificado en el contexto de la historia clínica del paciente y junto con otros datos clínicos y anatomopatológicos.

### 2. Relevancia clínica

Las translocaciones que afectan a los genes de inmunoglobulina (IG) son acontecimientos recurrentes de la oncogénesis de linfocitos B. En todas estas translocaciones, se activa y sobreexpresa un oncogén debido a su yuxtaposición junto a secuencias reguladoras de IG. El linfoma de Burkitt (LB) se caracteriza por translocaciones recíprocas que afectan al gen MYC y uno de los locus IG. La mayoría de las translocaciones afectan al locus de la cadena pesada de inmunoglobulina (IGH) mientras que una menor parte afecta a los locus de la cadena ligera de inmunoglobulina, ya sea la cadena ligera kappa (IGK) o la cadena ligera lambda (IGL). En hasta el 25 % de los casos de LB se han detectado reordenaciones de IGK e IGL resultantes de las translocaciones variantes t(2;8)(p11.2;q24.21) y t(8;22)(q24.21;q11.2), respectivamente. En el linfoma no hodgkiniano (LNH), que alberga reordenaciones de IG-MYC, el compañero de translocación de MYC es IGK, en el 8 % de los casos, e IGL, en el 22 %. Se han notificado translocaciones de IG en varias neoplasias malignas de linaje de linfocitos B distintas al LB, incluido linfoma atípico de Burkitt/linfoma tipo Burkitt, linfoma difuso de linfocitos B grandes, linfoma folicular, linfoma de células del manto y mieloma múltiple. Otros casos de reordenaciones afectan a los genes IGK e IGL, con los oncogenes BCL2 y BCL6 como compañeros de translocación. La detección de la afectación de IGK e IGL en linfomas mediante hibridación *in situ* con fluorescencia (FISH) puede ser una herramienta de diagnóstico y pronóstico útil.

### 3. Principio del ensayo

La técnica de hibridación *in situ* con fluorescencia (FISH) permite la detección y visualización de secuencias específicas de ácidos nucleicos en las preparaciones celulares. Los fragmentos de ADN marcados con fluorescencia, llamados *sondas FISH*, se desnaturalizan simultáneamente con sus cadenas diana de ADN complementario en las preparaciones y, posteriormente, se deja que se reasocien durante la hibridación. A continuación, los fragmentos inespecíficos y no unidos de la sonda se eliminan mediante pasos de lavado riguroso. Después de la contrainción del ADN con DAPI, los fragmentos de sonda hibridados se visualizan en un microscopio de fluorescencia equipado con filtros de excitación y emisión específicos para los fluorocromos con los que se han marcado directamente los fragmentos de sonda FISH.

### 4. Reactivos suministrados

La sonda ZytoLight SPEC IGK Dual Color Break Apart Probe se compone de:

- Polinucleótidos marcados en verde (excitación a 503 nm/emisión a 528 nm) ZyGreen (~10 ng/μl), dirigidos a secuencias localizadas en 2p11.2\* (chr2:88,382,616-89,153,517) distales a la región del punto de ruptura de IGK (ver Fig. 1).
- Polinucleótidos marcados en naranja (excitación a 547 nm/emisión a 572 nm) ZyOrange (~4,5 ng/μl), dirigidos a secuencias localizadas en 2p11.2\* (chr2:89,246,977-89,609,390 y chr2:89,853,315-90,089,156) proximales a la región del punto de ruptura de IGK (ver Fig. 1). Debido a los segmentos de secuencia homólogos proximales a la región del punto de ruptura de IGK, la sonda naranja presenta dos regiones de hibridación muy próximas.
- Tampón de hibridación basado en formamida

\*de acuerdo con el ensamblaje del genoma humano GRCh37/hg19

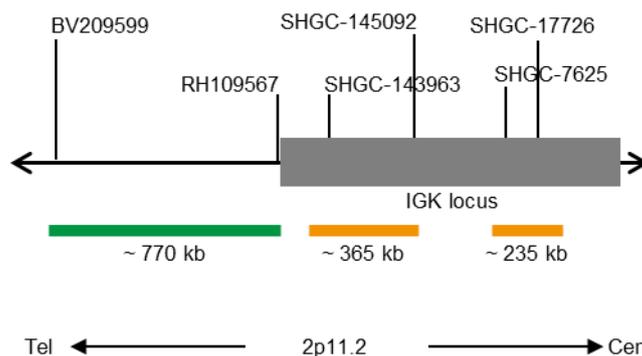


Fig. 1: SPEC IGK Mapa de la sonda (no está a escala)

La sonda ZytoLight SPEC IGK Dual Color Break Apart Probe está disponible en un tamaño:

- Z-2288-50: 0,05 ml (5 reacciones de 10 μl cada una)

### 5. Material necesario no suministrado

- Muestras de control positivas y negativas
- Hibridador o placa térmica
- Hibridador o cámara húmeda en horno de hibridación
- Cronómetro
- Cubetas o baños de tinción
- Termómetro calibrado
- Pipetas ajustables (10 μl, 25 μl)
- Alcohol reactivo o etanol
- Agua desionizada o destilada
- Cubreobjetos (22 mm x 22 mm, 24 mm x 60 mm)
- Adhesivo de caucho, p. ej., Fixogum Rubber Cement (Ref. E-4005-50/-125) o similar
- Microscopio de fluorescencia debidamente mantenido (400-1000x)
- Aceite de inmersión aprobado para microscopía de fluorescencia
- Juego de filtros adecuado

### Muestras citológicas

- ZytoLight FISH-Cytology Implementation Kit (Ref. Z-2099-20)
- Portaobjetos para microscopio, no recubiertos
- Baño María (70 °C)
- Formaldehído sin ácidos al 37 % o formol tamponado neutro al 10 %
- 2x citrato de sodio salino (SSC), p. ej., 20x SSC Solution (Ref. WB 0003-50)

### Muestras fijadas en formol e incluidas en parafina

- ZytoLight FISH-Tissue Implementation Kit (Ref. Z-2028-5/-20)
- Portaobjetos para microscopio, con carga positiva
- Baño María (37 °C, 98 °C)
- Xileno

## 6. Almacenamiento y manipulación

Almacenar a una temperatura de 2-8 °C en posición vertical y protegido de la luz.

Utilizar protegido de la luz. Volver a guardar de inmediato en las condiciones indicadas tras su uso. No utilizar los reactivos después de la fecha de caducidad indicada en la etiqueta. El producto es estable hasta la fecha de caducidad indicada en la etiqueta cuando se manipula debidamente.

## 7. Advertencias y precauciones

- Leer las instrucciones del producto antes del uso.
- No utilizar los reactivos después de la fecha de caducidad.
- Este producto contiene sustancias (en concentraciones y volúmenes bajos) que son perjudiciales para la salud y potencialmente infecciosas. Evitar cualquier contacto directo con los reactivos. Tomar las medidas de protección adecuadas (utilizar guantes desechables, gafas de protección e indumentaria de laboratorio).
- Si los reactivos entran en contacto con la piel, lavar inmediatamente con agua abundante.
- La ficha de datos de seguridad para el usuario profesional está disponible previa solicitud.
- No reutilizar los reactivos.
- Evitar la contaminación cruzada de las muestras, ya que esto puede generar resultados erróneos.
- La sonda no debe exponerse a la luz, especialmente la luz intensa, durante un período de tiempo prolongado, es decir, se deben realizar todos los pasos, en la medida de lo posible, en la oscuridad o empleando recipientes a prueba de luz.

### Indicaciones de peligro y consejos de prudencia:

El componente que determina el peligro es la formamida.



#### Peligro

|           |  |
|-----------|--|
| H351      | Susceptible de provocar cáncer.  |
| H360FD    | Puede perjudicar a la fertilidad. Puede dañar al feto.                               |
| H373      | Puede provocar daños en los órganos tras exposiciones prolongadas o repetidas.       |
| P201      | Solicitar instrucciones especiales antes del uso.                                    |
| P202      | No manipular antes de haber leído y comprendido todas las precauciones de seguridad. |
| P260      | No respirar polvos/humos/gases/nieblas/vapores/aerosoles.                            |
| P280      | Usar guantes/ropa de protección/equipo de protección para los ojos/la cara.          |
| P308+P313 | EN CASO DE exposición demostrada o supuesta: consultar a un médico.                  |
| P405      | Guardar bajo llave.  |

## 8. Limitaciones

- Para uso diagnóstico *in vitro*.
- Solo para uso profesional.
- La interpretación clínica de cualquier tinción positiva, o su ausencia, debe realizarse en el contexto de la historia clínica, la morfología, otros criterios histopatológicos, así como otras pruebas diagnósticas. Es responsabilidad de un anatomopatólogo cualificado familiarizarse con las sondas FISH, los reactivos, los grupos de pruebas diagnósticas y los métodos utilizados para obtener la preparación teñida. La tinción se debe llevar a cabo en un laboratorio certificado y autorizado, bajo la supervisión de un anatomopatólogo que sea responsable de examinar los portaobjetos teñidos y de garantizar la idoneidad de los controles positivos y negativos.
- La tinción de muestras, en particular la intensidad de la señal y la tinción de fondo, depende de la manipulación y el procesamiento de la muestra antes de la tinción. La fijación, congelación, descongelación, lavado, secado, calentamiento o corte inadecuados, o la contaminación con otras muestras o líquidos, pueden producir artefactos o resultados falsos. Los resultados incoherentes pueden deberse a variaciones en los métodos de fijación e inclusión, así como a irregularidades inherentes a la propia muestra.
- La sonda solo debe utilizarse para detectar los locus descritos en 4. "Reactivos suministrados".
- El rendimiento se validó utilizando los procedimientos descritos en estas instrucciones de uso. Cualquier modificación de estos procedimientos podría variar el rendimiento, por lo que debe validarla el usuario.

## 9. Sustancias interferentes

Los eritrocitos presentes en la muestra podrían presentar autofluorescencia, lo que dificulta el reconocimiento de señales.

Los siguientes fijadores son incompatibles con FISH:

- Fijador de Bouin
- Fijador B5
- Fijadores de ácidos (p. ej., ácido pícrico)
- Fijador de Zenker
- Alcoholes (cuando se usan solos)
- Cloruro de mercurio
- Fijador de formaldehído/zinc
- Fijador de Hollande
- Formol no tamponado

## 10. Preparación de muestras

### Muestras citológicas

- Preparar las muestras tal como se describe en las instrucciones de uso de ZytoLight FISH-Cytology Implementation Kit.

### Muestras fijadas en formol e incluidas en parafina

- Fijación en formol tamponado neutro al 10 % durante 24 horas a temperatura ambiente (18-25 °C).
- Tamaño de muestra  $\leq 0,5 \text{ cm}^3$ .
- Utilizar parafina de calidad superior.
- La inclusión se debe realizar a temperaturas inferiores a 65 °C.
- Preparar cortes de micrótomo de 2-4  $\mu\text{m}$ .
- Utilizar portaobjetos de microscopio cargados positivamente.
- Fijar durante 2-16 h a 50-60 °C.

## 11. Preparación previa del producto

El producto está listo para usar. No precisa reconstitución, mezcla ni dilución. Llevar la sonda a temperatura ambiente (18-25 °C) antes del uso; proteger de la luz. Antes de abrir el frasco, mezclar en agitadora vorticial y centrifugar brevemente.

## 12. Procedimiento de ensayo

### Muestras citológicas

#### Pretratamiento de la muestra

Realizar el pretratamiento de la muestra de acuerdo con las instrucciones de uso de ZytoLight FISH-Cytology Implementation Kit.

#### Desnaturalización e hibridación

1. Pipetear 10  $\mu$ l de la sonda en cada muestra pretratada.
2. Cubrir las muestras con un cubreobjetos de 22 mm x 22 mm (evitando que queden burbujas) y sellarlo.

*Se recomienda utilizar adhesivo de caucho (p. ej., Fixogum) para el sellado.*

3. Colocar los portaobjetos en una placa térmica o un hibridador y desnaturalizar las muestras durante 5 minutos a 72 °C.
4. Transferir el portaobjetos a una cámara de atmósfera húmeda y dejar hibridar toda la noche a 37 °C (p. ej., en un horno de hibridación).

*Es imprescindible que las muestras no se sequen durante la etapa de hibridación.*

#### Post-hibridación

Realizar el procesamiento post-hibridación (lavado, contratinción, microscopia de fluorescencia) de acuerdo con las instrucciones de uso de ZytoLight FISH-Cytology Implementation Kit.

### Muestras fijadas en formol e incluidas en parafina

#### Pretratamiento de la muestra

Realizar el pretratamiento de la muestra (desparafinación, proteólisis) de acuerdo con las instrucciones de uso de ZytoLight FISH-Tissue Implementation Kit.

#### Desnaturalización e hibridación

1. Pipetear 10  $\mu$ l de la sonda en cada muestra pretratada.
2. Cubrir las muestras con un cubreobjetos de 22 mm x 22 mm (evitando que queden burbujas) y sellarlo.

*Se recomienda utilizar adhesivo de caucho (p. ej., Fixogum) para el sellado.*

3. Colocar los portaobjetos en una placa térmica o un hibridador y desnaturalizar las muestras durante 10 minutos a 75 °C.
4. Transferir los portaobjetos a una cámara húmeda y dejar hibridar toda la noche a 37 °C (p. ej., en un horno de hibridación).

*Es imprescindible que las muestras no se sequen durante la etapa de hibridación.*

#### Post-hibridación

Realizar el procesamiento post-hibridación (lavado, contratinción, microscopia de fluorescencia) de acuerdo con las instrucciones de uso de ZytoLight FISH-Tissue Implementation Kit.


## 13. Interpretación de los resultados

Con el uso de juegos de filtros adecuados, las señales de hibridación de la sonda aparecen en color verde (distales a la región del punto de ruptura de IGK) y naranja (proximales a la región del punto de ruptura de IGK).

**Situación normal:** En las interfases de células normales o células sin una translocación que afecte a la región del locus de IGK, aparecen dos señales de fusión verdes o naranjas (ver Fig. 2). Debido a las dos regiones de hibridación de la sonda naranja, las señales naranjas pueden aparecer como puntos de señal emparejados.

**Situación anómala:** Un locus de IGK afectada por una translocación se indica mediante una señal verde independiente y una señal naranja independiente. Debido a las dos regiones de hibridación de la sonda naranja, las señales naranjas pueden aparecer como puntos de señal emparejados (ver Fig. 2).

*Las señales superpuestas pueden aparecer como señales en color amarillo.*

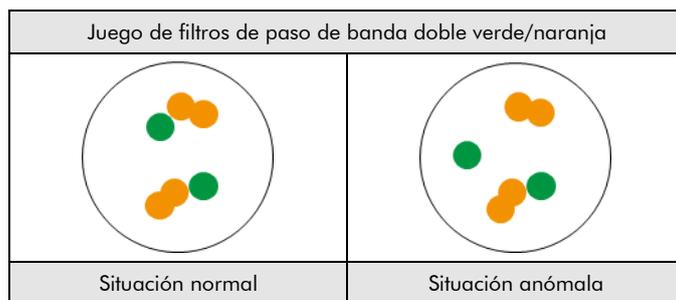

**Fig. 2: Resultados previstos en núcleos normales y anómalos**

Las anomalías genómicas debidas a pequeñas deleciones, duplicaciones o inversiones pueden dar lugar a patrones de señal discretas.

Se puede observar otra distribución de señales en algunas muestras anómalas que podría dar lugar a un patrón de señal diferente al descrito anteriormente, lo que indica diferentes reordenaciones. Los patrones de señales no previstos se deben estudiar más a fondo.

#### Nota:

- Debido a la cromatina descondensada, las señales individuales de FISH pueden aparecer como pequeños grupos de señales. Por tanto, dos o tres señales del mismo tamaño, separadas por una distancia  $\leq$  al diámetro de una señal, deben contarse como una sola señal.
- No evaluar los núcleos superpuestos.
- No contar los núcleos sobredigeridos (que se reconocen por áreas oscuras visibles en el interior de los núcleos).
- No contar los núcleos con fuerte autofluorescencia, la cual dificulta el reconocimiento de señales.
- Un resultado negativo o inespecífico puede deberse a múltiples factores (ver el apartado 17).

Para interpretar correctamente los resultados, el usuario debe validar este producto antes de utilizarlo en los procedimientos diagnósticos de acuerdo con las directrices nacionales o internacionales.

## 14. Procedimientos de control de calidad recomendados

Para controlar el correcto rendimiento de las muestras procesadas y los reactivos analíticos, cada ensayo debe ir acompañado de controles internos y externos. Si los controles internos o externos no revelan una tinción adecuada, los resultados de las muestras del paciente deben considerarse no válidos.

**Control interno:** Células no neoplásicas en la muestra que presentan un patrón de señal normal.

**Control externo:** Muestras de control positivas y negativas validadas.

## 15. Características de rendimiento

### Muestras citológicas

El rendimiento se evaluó de acuerdo con las instrucciones de uso de ZytoLight FISH-Cytology Implementation Kit.

**Exactitud:** El lugar de la hibridación de la sonda se evaluó en extensiones metafásicas de un varón cariotípicamente normal. En todas las muestras analizadas, la sonda se hibridó únicamente con los locus esperados. No se observaron señales adicionales o hibridaciones cruzadas. Por lo tanto, se calculó que la exactitud era del 100 %.

**Sensibilidad analítica:** Para la evaluación de la sensibilidad analítica, la sonda se evaluó en extensiones metafásicas de varones cariotípicamente normales. Todos los núcleos mostraron el patrón de señal normal previsto en todas las muestras analizadas. Por lo tanto, se calculó que la sensibilidad analítica era del 100 %.

**Especificidad analítica:** Para la evaluación de la especificidad analítica, la sonda se evaluó en extensiones metafásicas de varones cariotípicamente normales. En todas las muestras analizadas, todas las señales se hibridaron únicamente con los locus objetivo esperados y no con otros locus. Por lo tanto, se calculó que la especificidad analítica era del 100 %.

## Muestras fijadas en formol e incluidas en parafina

El rendimiento se evaluó de acuerdo con las instrucciones de uso de *ZytoLight FISH-Tissue Implementation Kit*.

**Exactitud:** El lugar de la hibridación de la sonda se evaluó en extensiones metafásicas de un varón cariotípicamente normal. En todas las muestras analizadas, la sonda se hibridó únicamente con los locus esperados. No se observaron señales adicionales o hibridaciones cruzadas. Por lo tanto, se calculó que la exactitud era del 100 %.

**Sensibilidad analítica:** Para la evaluación de la sensibilidad analítica, la sonda se evaluó en extensiones metafásicas de varones cariotípicamente normales. Todos los núcleos mostraron el patrón de señal normal previsto en todas las muestras analizadas. Por lo tanto, se calculó que la sensibilidad analítica era del 100 %.

**Especificidad analítica:** Para la evaluación de la especificidad analítica, la sonda se evaluó en extensiones metafásicas de varones cariotípicamente normales. En todas las muestras analizadas, todas las señales se hibridaron únicamente con los locus objetivo esperados y no con otros locus. Por lo tanto, se calculó que la especificidad analítica era del 100 %.

## 16. Eliminación

La eliminación de los reactivos debe llevarse a cabo de acuerdo con las normativas locales.

## 17. Resolución de problemas

Cualquier desviación de las instrucciones de uso puede producir resultados de tinción inferiores o ausencia de tinción. Algunos de los consejos de este apartado solo se aplican cuando se utiliza *ZytoLight FISH-Tissue Implementation Kit*.

### Señales débiles o ausencia de señales

| Posible causa   | Medida  |
|---|---|
| No hay secuencias objetivo disponibles  | Uso de los controles apropiados disponibles   |
| Muestra celular o tisular no fijada correctamente   | Optimizar el tiempo de fijación y el fijador o aplicar un paso posterior a la fijación como se describe en "Procedimiento de ensayo" del manual de <i>ZytoLight FISH-Tissue Implementation Kit</i>  |
| Pretratamiento con calor, proteólisis, desnaturalización, hibridación o temperatura de lavado riguroso incorrecta | Comprobar la temperatura de todos los aparatos técnicos utilizados mediante un termómetro calibrado   |
| Pretratamiento proteolítico no realizado correctamente  | Optimizar el tiempo de incubación con pepsina, aumentar o disminuir si es necesario   |
| Evaporación de la sonda   | Cuando se utiliza un hibridador, es obligatorio el uso de bandas húmedas/tanques llenos de agua. Cuando se utiliza un horno de hibridación, se requiere el uso de una cámara húmeda. Además, el cubreobjetos se debe sellar completamente, por ejemplo, con Fixogum, para evitar que la muestra se seque durante la hibridación |
| Tampón de lavado riguroso con una concentración demasiado baja  | Comprobar la concentración de tampón de lavado riguroso   |
| Soluciones de deshidratación antiguas   | Preparar soluciones de deshidratación recientes   |
| Microscopio de fluorescencia mal ajustado   | Ajustar correctamente   |

|  |  |
|--|--|
| Se han utilizado juegos de filtros inadecuados | Utilizar juegos de filtros adecuados para los fluorocromos de la sonda. <i>Los juegos de filtros de paso de banda triple proporcionan menos luz en comparación con los juegos de filtros de paso de banda simple o doble. Por consiguiente, las señales pueden ser más débiles con estos juegos de filtros de paso de banda triple</i> |
| Fotodaño de las sondas/fluoróforos             | Realizar los pasos de hibridación y lavado en la oscuridad   |

### Señales de hibridación cruzada; ruido de fondo

| Posible causa  | Medida   |
|--|--|
| Desparafinación incompleta   | Utilizar soluciones recién preparadas; comprobar la duración de la desparafinación                             |
| Tratamiento proteolítico previo demasiado intenso                            | Reducir el tiempo de incubación con pepsina  |
| Volumen de sonda por área demasiado alto                                     | Reducir el volumen de sonda por corte/área; distribuir la sonda gota a gota para evitar la concentración local |
| Los portaobjetos se enfriaron a temperatura ambiente antes de la hibridación | Transferir los portaobjetos rápidamente a 37 °C  |
| Tampón de lavado riguroso con una concentración demasiado alta               | Comprobar la concentración de tampón de lavado riguroso  |
| Temperatura de lavado después de la hibridación demasiado baja               | Comprobar la temperatura; aumentar si es necesario   |
| Deshidratación de las muestras entre los distintos pasos de incubación       | Sellar los portaobjetos y realizar la incubación en un ambiente húmedo para evitar la deshidratación           |

### Morfología degradada

| Posible causa  | Medida   |
|--|--|
| La muestra celular o tisular no se ha fijado correctamente | Optimizar el tiempo de fijación y el fijador o aplicar un paso posterior a la fijación como se describe en "Procedimiento de ensayo" del manual de <i>ZytoLight FISH-Tissue Implementation Kit</i> |
| Pretratamiento proteolítico no realizado correctamente     | Optimizar el tiempo de incubación con pepsina, aumentar o disminuir si es necesario  |
| Secado insuficiente antes de la aplicación de la sonda     | Prolongar el secado al aire  |

### Núcleos superpuestos

| Posible causa                                | Medida                                 |
|--|--|
| Grosor inadecuado de los cortes histológicos | Preparar cortes de micrótopo de 2-4 µm |

### La muestra se desliza fuera del portaobjetos

| Posible causa                                     | Medida                                      |
|---|---|
| Recubrimiento poco apropiado del portaobjetos     | Utilizar portaobjetos adecuados             |
| Tratamiento proteolítico previo demasiado intenso | Reducir el tiempo de incubación con pepsina |

### Contratinción débil

| Posible causa                                | Medida  |
|--|---|
| Solución DAPI de concentración baja          | Utilizar <u>DAPI/DuraTect-Solution (ultra)</u> (Ref. MT-0008-0.8) en su lugar |
| Tiempo de incubación de DAPI demasiado corto | Ajustar el tiempo de incubación de DAPI                                       |

### 18. Bibliografía

- Cario G, et al. (2000) *Br J Haematol* 110: 537-46.
- Einerson EE, et al. (2006) *Leukemia* 20: 1790-9.
- Henglein B, et al. (1989) *Mol Cell Biol* 9: 2105-13.
- Kievits T, et al. (1990) *Cytogenet Cell Genet* 53: 134-6.
- Martín-Subero JJ, et al. (2002) *Int J Cancer* 98: 470-4.
- Poulsen TS, et al. (2002) *Leukemia* 16: 2148-55.
- Wilkinson DG: *In Situ Hybridization, A Practical Approach*, Oxford University Press (1992) ISBN 0 19 963327 4.

Nuestros expertos están a su disposición para resolver cualquier duda. Póngase en contacto con [helptech@zytovision.com](mailto:helptech@zytovision.com)



ZytoVision GmbH  
Fischkai 1  
27572 Bremerhaven/Alemania  
Teléfono: +49 471 4832-300  
Fax: +49 471 4832-509  
[www.zytovision.com](http://www.zytovision.com)  
Correo electrónico: [info@zytovision.com](mailto:info@zytovision.com)

#### Marcas comerciales:

ZytoVision® y ZytoLight® son marcas comerciales de ZytoVision GmbH.